

< 20 - 1 >

2020年1月

先生各位

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象項目:

・血中 フェノバルビタール 濃度

[項目コード:3687]

(LA法)→(CLEIA法)

■変更内容:

●血中 フェノバルビタール濃度

精度の向上と安定性から検査方法(測定試薬)を変更いたします。

■変更実施日:

2020年 1月 17 日(金)受付分より


以上

※ 変更内容等につきましては、次ページ以降をご覧ください。

●血中 フェノバルビタール濃度

検査方法を変更させていただきます。この変更に伴う、基準値、単位及び所要日数等の変更はございません。

《新法と現法の比較》

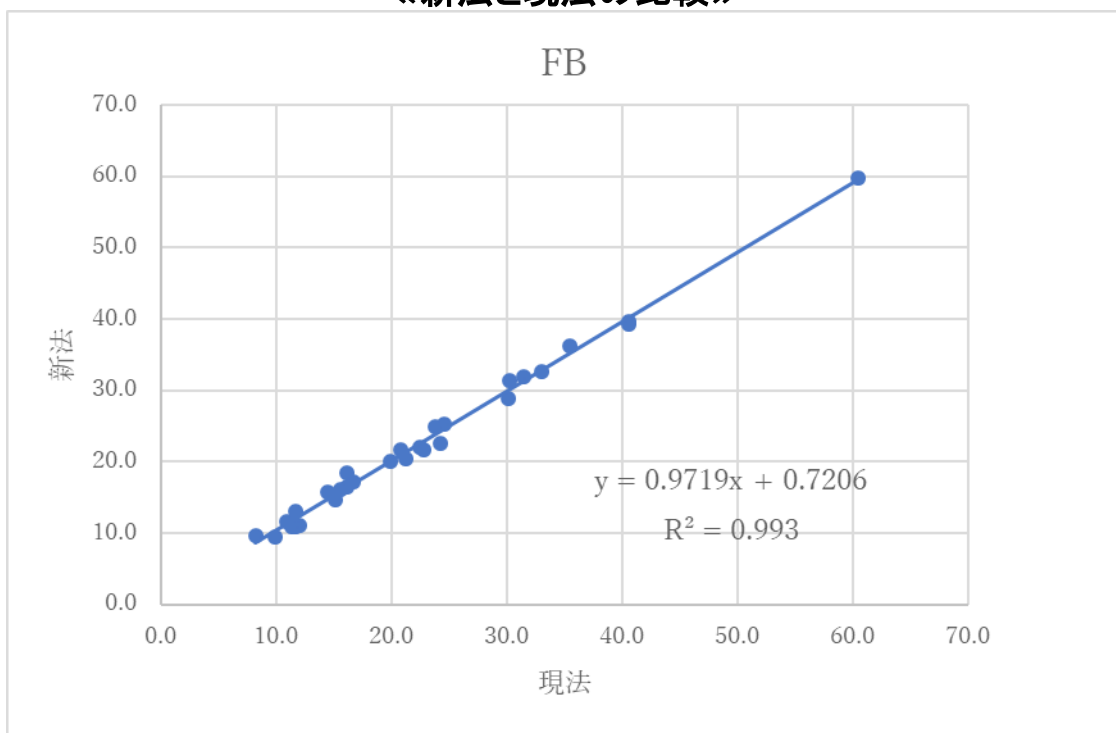

現測定方法(LA)と新たに開始する検査方法(CLEIA)での相関は良好に取れております。

また、使用試薬の希釈直線性、保存安定性についても現行法より安定していることは検証済みです。